


Wyznaczanie czasu T1 dla wody


MR 1.5T GE

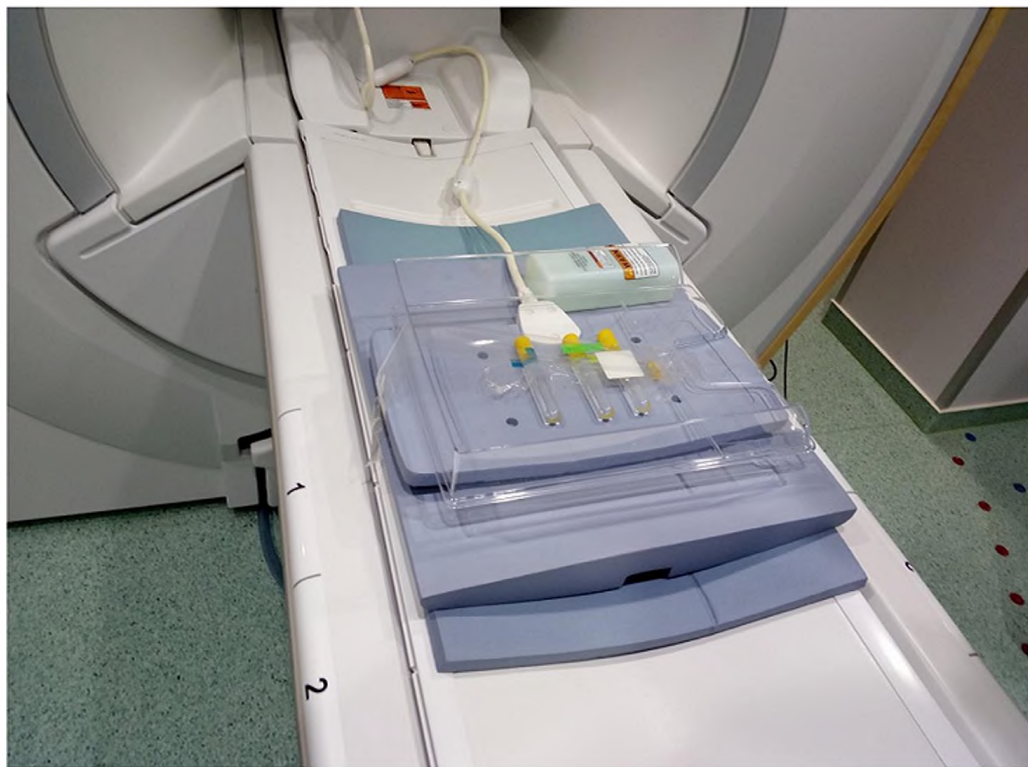

1. Układ pomiarowy. Cewka Flex Small


Wyznaczanie czasu T1 dla wody

MR 1.5T GE

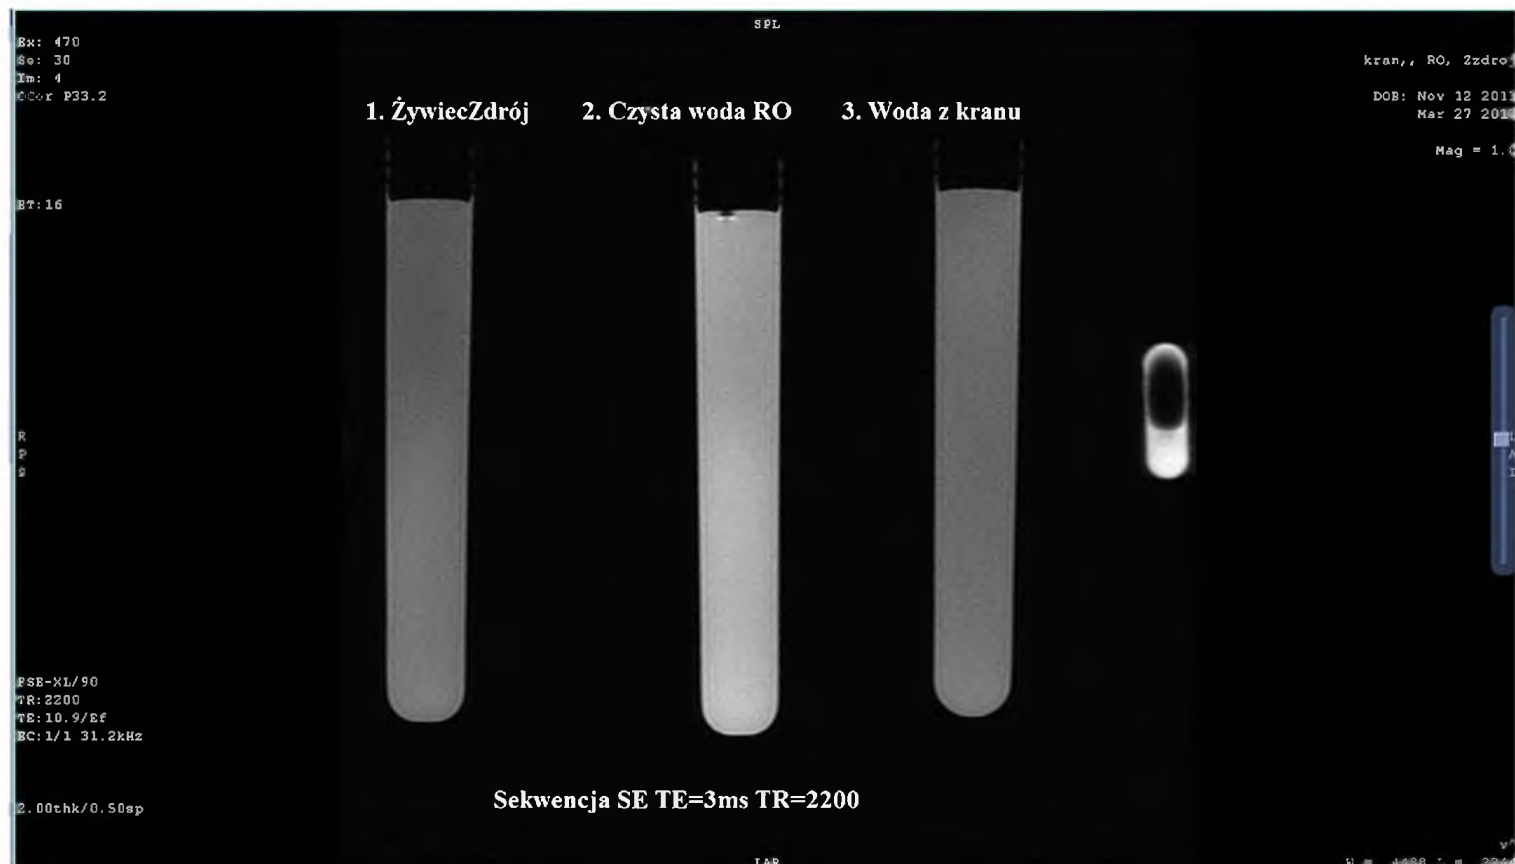


Wyznaczanie czasu T1 dla wody

MR 1.5T GE

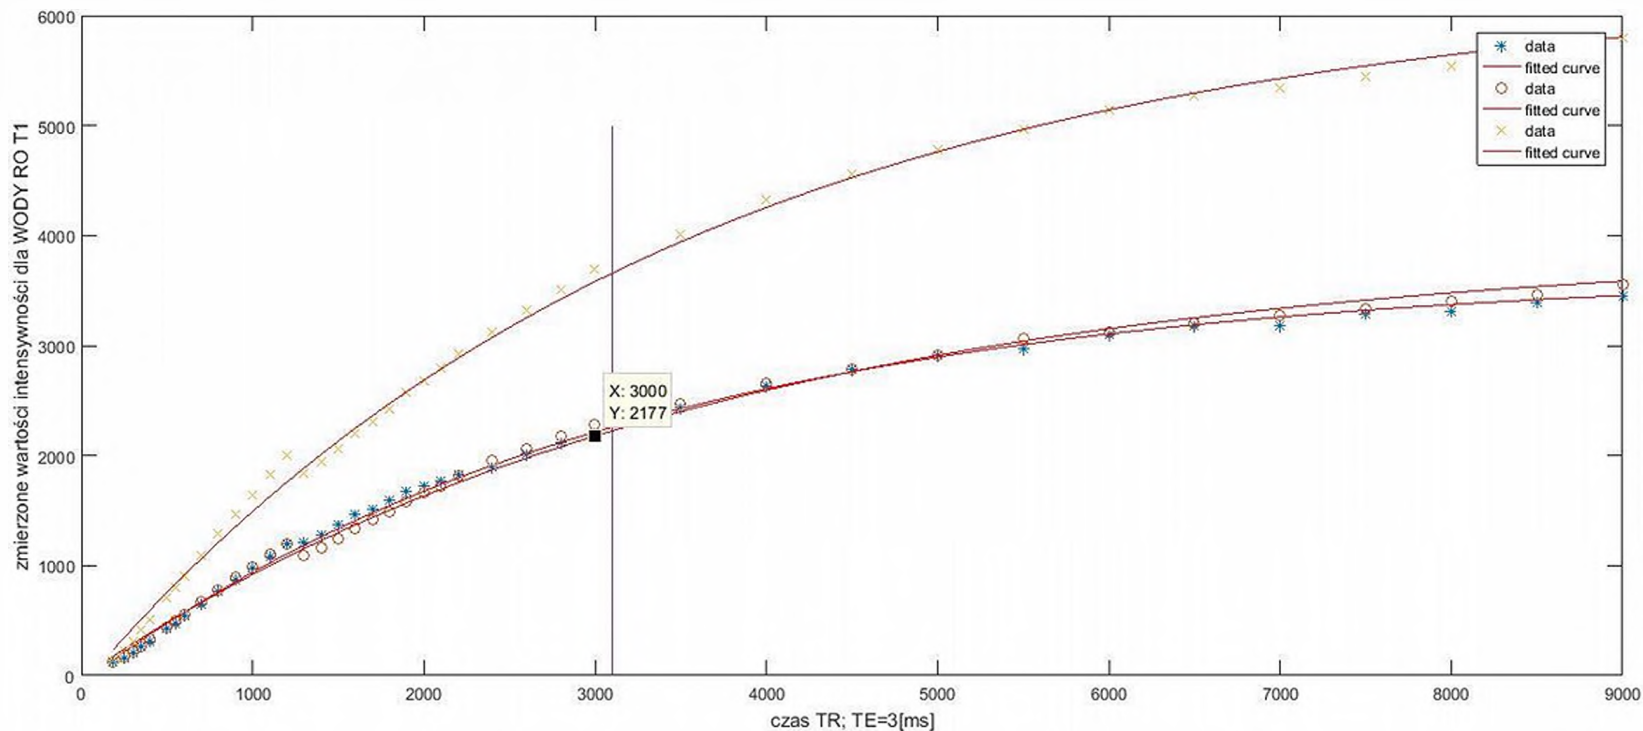

Krzywe relaksacji dla wody

Wyznaczanie czasu T_1 dla CuSO_4 MR 1.5T GE

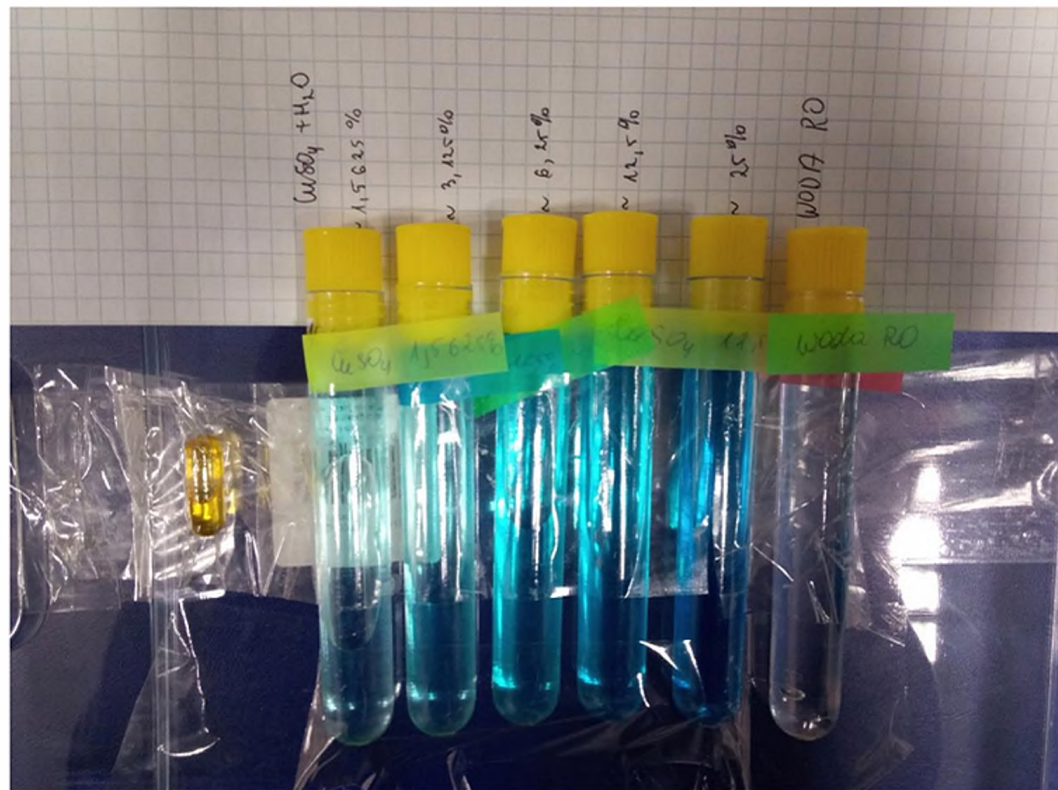

1. Układ pomiarowy. Cewka Flex Small

Wyznaczanie czasu T1 dla CuSO4 o różnych stężeniach MR 1.5T GE

